

ネリザ軟膏包装変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、ネリザ軟膏につきまして下記のとおり、2g×14 包装品は個装箱の仕様を変更致します。また、既にご案内させて頂いておりますが、全包装につきまして、添付文書の封入を廃止致します。更に、同梱の患者向け説明書を順次変更致します。

当分の間、新旧製品が市場に流通することとなり、何かとご迷惑をおかけ致しますが、今後とも引き続き弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

記

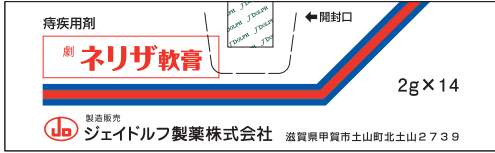
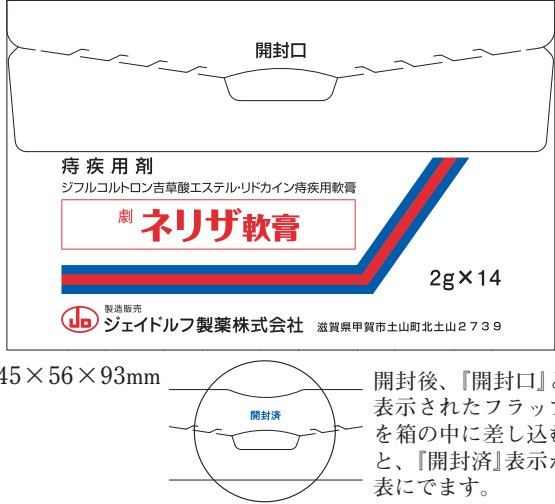


■ 変更内容

<2g×14 包装品のみ>

- ① 個装箱の開封仕様を差込フラップ・テープ封緘からオーバーフラップ・糊封緘へ変更致します。
- ② 個装箱の寸法を変更致します。(130×92×40mm → 145×56×93mm)
- ③ 7連包シートの入れ方を変更致します。

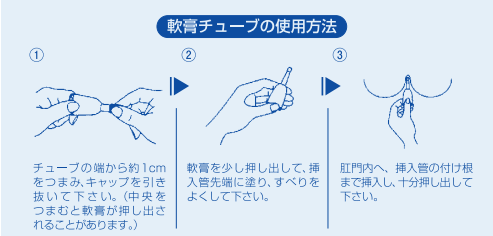
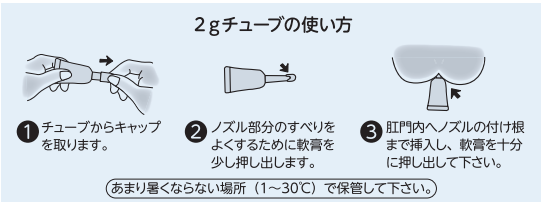
<全包装共通>

- ① 添付文書の封入廃止
- ② 患者向け説明書を変更

| 従 来 品 | 変 更 品 |
|--|--|
|  <p>130×92×40mm</p> |  <p>145×56×93mm</p> <p>開封後、『開封口』と表示されたフラップを箱の中に差し込むと、『開封済』表示が表にできます。</p> |
|  |  |

※ 2g チューブ、ピローの変更はございません。

(裏面もご覧下さい。)

| 従来品 | 変更品 |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">軟膏チューブの使用方法</p>  <p>① チューブの端から約1cmをつまみ、キャップを引き抜いて下さい。(中央をつまむと軟膏が押し出されることがあります。)</p> <p>② 軟膏を少し押し出して、挿入管先端に塗り、すべりをよくして下さい。</p> <p>③ 肛門内へ、挿入管の付け根まで挿入し、十分押し出して下さい。</p> <p style="text-align: center;">≫ 使用上の注意 ‹‹</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 医師の指示を守り、正しくご使用下さい。 2. 眼科用(点眼)として使用しないで下さい。 3. 小児の手の届かない所に保管して下さい。 4. 高温を避け、室温(1~30℃)で保管して下さい。 5. 使用後のチューブは、紙などに包んでごみ箱にお捨て下さい。 <p style="text-align: right;">J - 2</p> <p>120×59mm</p> | <p style="text-align: center;">2gチューブの使い方</p>  <p>① チューブからキャップを取ります。</p> <p>② ノズル部分のすべりをよくするために軟膏を少し押し出します。</p> <p>③ 肛門内へノズルの付け根まで挿入し、軟膏を十分に押し出して下さい。</p> <p style="text-align: center;">(あまり暑くない場所(1~30℃)で保管して下さい。)</p> <p style="text-align: center;">使用上の注意</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 医師の指示を守り、正しくご使用下さい。 2. 眼には使用しないで下さい。 3. 小児の手の届かない所に保管して下さい。 4. 夏場、軟膏が柔らかい場合は冷蔵庫等で少し冷やして硬くし、冬場、軟膏が硬い場合は手等で少し温めて柔らかくしてからご使用下さい。 5. 使用後のチューブは、紙等に包んでごみ箱にお捨て下さい。 <p style="text-align: right;">J - 3</p> <p>130×50mm</p> |

■ 変更時期

| 製品名 | 包装規格 | 変更品の製造番号 (使用期限) | 出荷時期 |
|-------|--------|--------------------|----------|
| ネリザ軟膏 | 2g×14 | A101 (2024.09) | 2022年 1月 |
| | 2g×70 | A093 (2024.08) | 2021年12月 |
| | 2g×140 | A110 (2024.09) | 2022年 1月 |
| | 2g×350 | A088 (2024.08) | 2021年11月 |

※流通の関係から出荷時期が前後することがありますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い致します。
 ※患者向け説明書の変更は順次行いますので、上記製造番号とは一致しません。

■ 対 応

<2g×14 包装品>

当分の間、変更品には **包装変更品**、**添付文書封入なし** と表示致します。

<2g×70、2g×140、2g×350 包装品>

当分の間、変更品には **添付文書封入なし** と表示致します。

以 上

【お問合せ先】

ジェイドルフ製薬株式会社 営業本部 企画管理部
 〒 570-0081 大阪府守口市日吉町 2-5-15
 TEL : 06-7507-2535
 URL : <http://www.j-dolph.co.jp>