

ヘモレックス軟膏 包装変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、「ヘモレックス軟膏」につきまして、下記のとおり包装仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。

当分の間、新旧製品が市場に流通することとなり、何かとご迷惑おかけ致しますが、今後とも引き続き弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

記

■ 変更内容

1. ピロー包装の変更

- ①ピロー包装のデザインを変更致します。
- ②ピロー包装のシールを四方シールから三方シールへ変更致します。
- ③開け口形状をI字からV字へ変更致します。
- ④包装材質構成をセロハン／PE から PET／PE へ変更致します。


※ プラ表示は重量的に主たる素材が PE のため、変更はございません。

※ 表層面をセロハンから PET へ変更しましたので、感触は少し柔らかくなります。

PET：ポリエチレンテレフタレート、PE：ポリエチレン

2. 使用期限・製造番号の表示方法の変更

- ①使用期限表示をピロー包装上面からチューブ尾部へ変更致します。
- ②チューブ尾部の製造番号表示を刻印からレーザー捺印に変更致します。

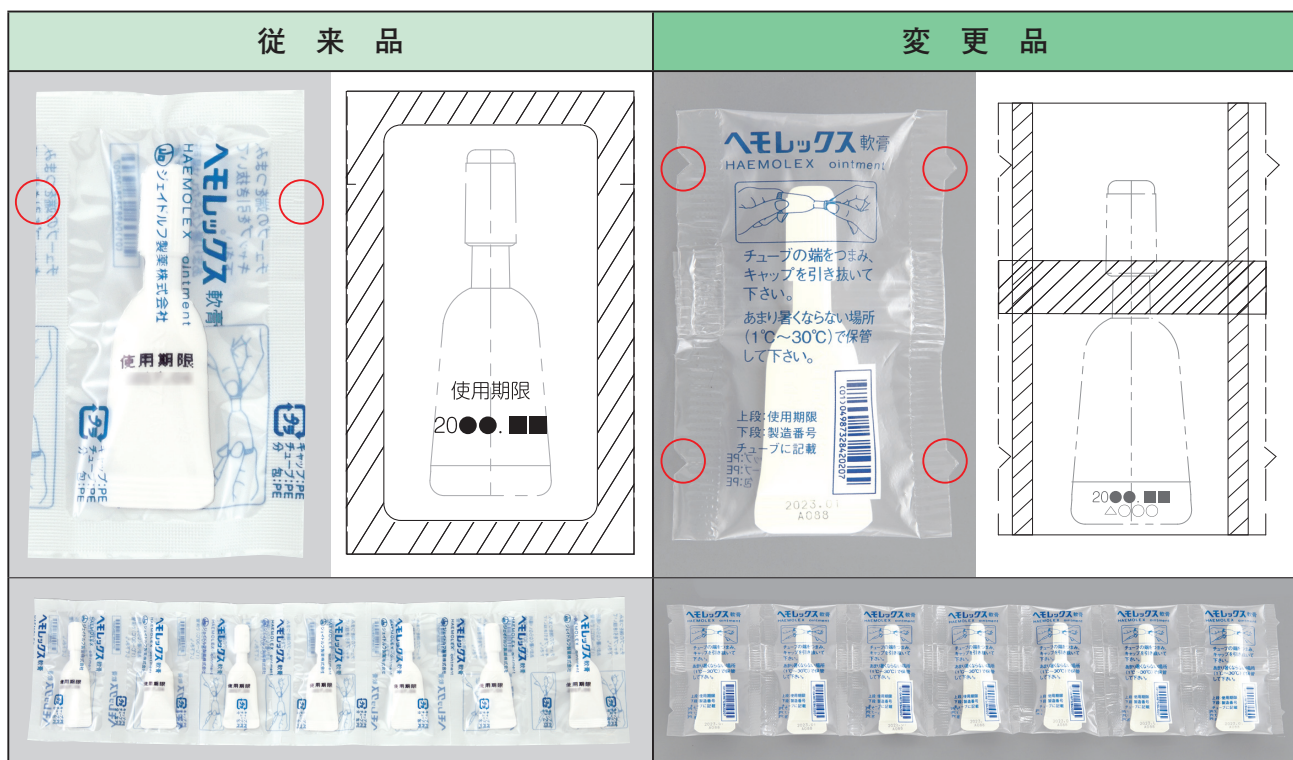

※ 2g チューブの変更はございません。

※ 20g×20 についての変更はございません。

(裏面もご覧下さい。)

■ 変更時期

製品名	包装規格	変更品の製造番号 (使用期限)	出荷時期
ヘモレックス軟膏	2g × 70	A125 (2023.03)	2021 年 7 月
	2g × 350	A087 (2023.01)	2021 年 6 月

※流通の関係から出荷時期が前後することがありますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い致します。

■ 対 応

当分の間、変更品には **包装変更品** と表示し、患者様用のお知らせカードを封入致します。

ヘモレックス軟膏のお知らせ


フィルム包装のデザイン、包装材質構成、使用期限の表示方法などを変更致しました。(裏面をご参照下さい。)

チューブ、お薬の成分・効果は従来と変わりません。
指示を守ってご使用下さい。

ジェイドルフ製薬株式会社

2g × 70 1 冊 (10 枚綴り)
2g × 350 3 冊 (10 枚綴り)

※患者様用お知らせカードは 2g×70、2g×350
のみです

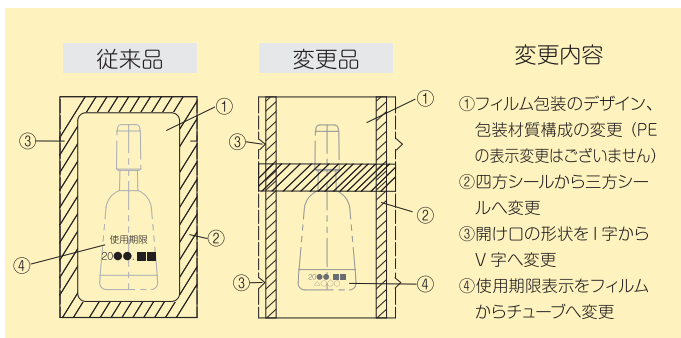

以 上

【お問合せ先】

ジェイドルフ製薬株式会社 営業本部 企画管理部
〒 570-0081 大阪府守口市日吉町 2-5-15
TEL : 06-7507-2535
URL : <http://www.j-dolph.co.jp>